


## ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ТПР-0290 (ТУ У 33.2-04850451-088:2007)

Призначений для вимірювання температури рідкої сталі шляхом короткочасного (5 с) занурювання пакета термоперетворювача ПТПР-0290 у вимірюване середовище з наступною його заміною. Пакети типу ПТПР-0290 є виробами разового використання і можуть поставлятися як самостійний виріб згідно з ТУ У 33.2-04850451-089:2007.

Робочий діапазон вимірюваних температур, °С	<b>від 1000 до 1800</b>
Літерна позначка НСХ	<b>В</b>
Клас	<b>2 або 3</b>
Показник теплової інерції, с, не більше	<b>2</b>
Тривалість перебування пакета ПТПР-0290 у розплавленій сталі (час одного виміру), не більше, с	<b>5</b>
Після вимірювання пакет підлягає заміні.	

На вимогу споживача допускається постачання пакетів ПТПР-0290 (рис. 3) з довжиною гільзи з ряду: 100; 200; 250; 300; 500; 600; 900; 1000; 1200 мм.

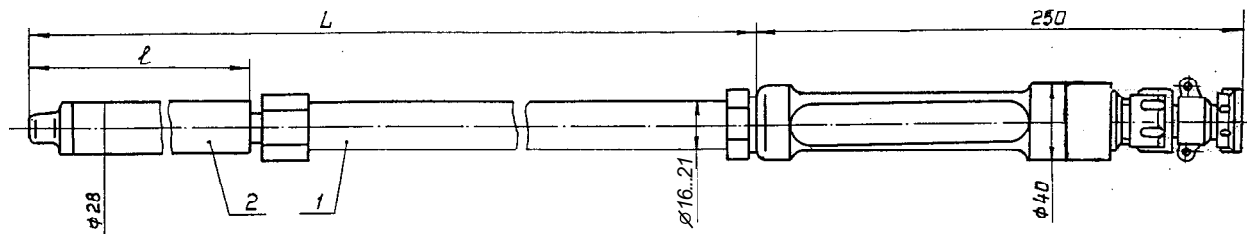

1 - корпус, 2 - змінний пакет  
Рис. 1 - ТПР-0290

Позначення	Виконання	L, мм	l, мм
БАУИ.405223.001	ТПР-0290	1600	250
-01	ТПР-0290-01	2000	500
-02	ТПР-0290-02	2500	
-03	ТПР-0290-03	3150	1000
-04	ТПР-0290-04	4000	
-05	ТПР-0290-05	4500	1200




Рис. 2 - Пакет ПТТР-0290

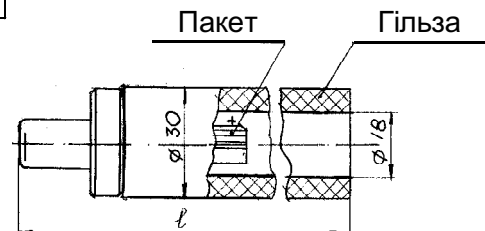


Рис. 3

Позначення	Виконання	Рис.	l, мм
БАУИ.408713.009	ПТТР-0290	2	60
-01	ПТТР-0290-01	3	250
-02	ПТТР-0290-02		500
-03	ПТТР-0290-03		1000
-04	ПТТР-0290-04		1200